Evolutis
CREATEUR FABRICANT

▸ Cette armature est destinée aux reconstructions cotyloïdiennes.

Une patte sur l'illion reçoit 3 vis à corticale auto-taraudeuses en inox de diamètre 4,5 à 6 mm

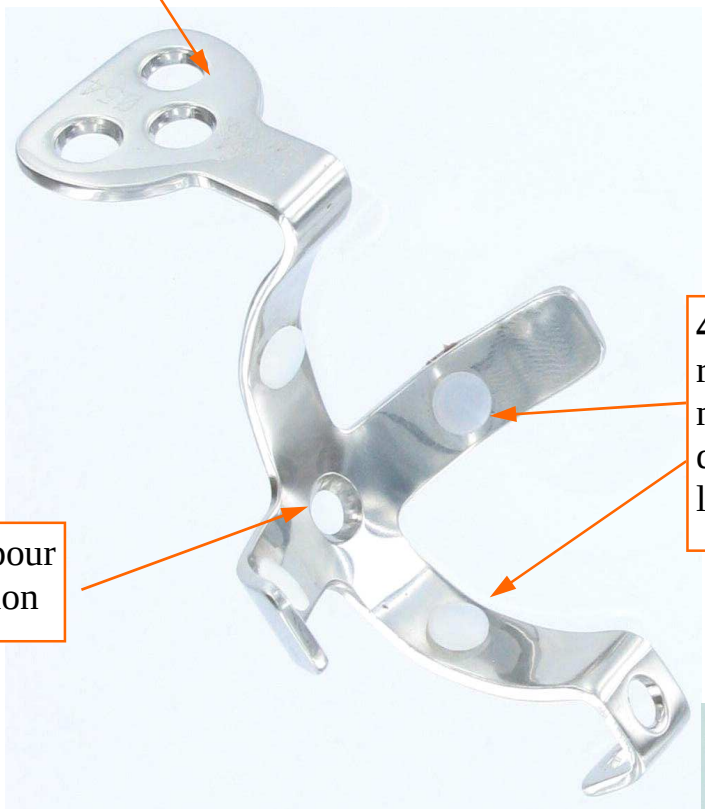

4 plots en polyéthylène garantissent un manteau de ciment régulier de 1,5 mm d'épaisseur entre la croix et la cupule.

Un taraudage pour faciliter la préhension

FOND DE COTYLE ™

Armature de type 'CROIX DE KERBOULL'

Evolutis
CREATEUR FABRICANT

TECHNIQUE OPERATOIRE

1- Mise en place des greffons. Compaction et choix de la taille.

2– Visser l'armature d'essai sur le manche et tester la taille.

3- Positionnement de l'armature et fixation par des vis d'ostéosynthèse impérativement en inox et de diamètre compris entre 4,5 et 6 mm.

4- Cimentage du cotyle. Les espaceurs en polyéthylène garantissent une épaisseur régulière du ciment et élimine les risques de corrosion galvanique par absence de contact entre l'armature inox 316L et le cotyle, éventuellement dans métal différent.

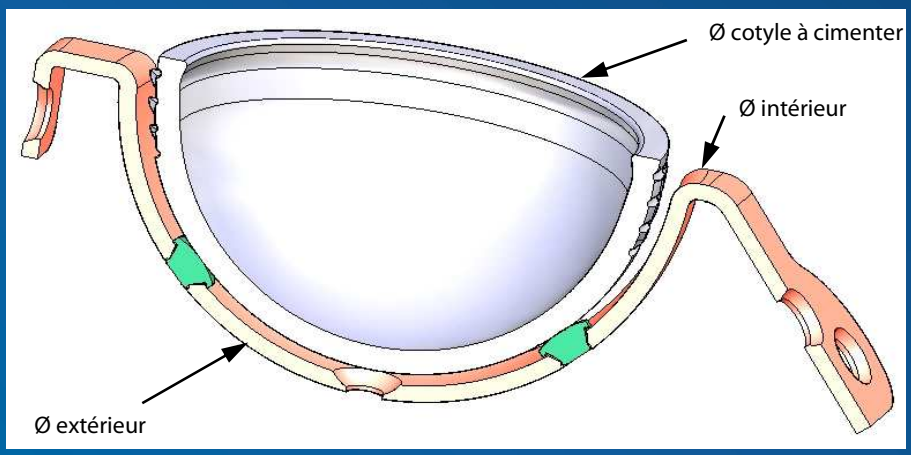

VIS	
Référence	Désignation
H16 S5035	Vis Ø5 Lg 35 mm
H16 S5040	Vis Ø5 Lg 40 mm
H16 S5045	Vis Ø 5 Lg 45 mm
H16 S5050	Vis Ø 5 Lg 50 mm
H16 S5055	Vis Ø5 Lg 55 mm
H16 S5060	Vis Ø5 Lg 60 mm

Référence	Désignation	Ø extérieur	Ø intérieur	Ø cotyle à cimenter
H13 050	Fond de cotyle Ø 50	Ø54	Ø 50	Ø 45 à 47
H13 054	Fond de cotyle Ø 54	Ø 58	Ø 54	Ø 49 à 51
H13 058	Fond de cotyle Ø 58	Ø 62	Ø 58	Ø 53 à 55
H13 062	Fond de cotyle Ø 62	Ø 66	Ø 62	Ø 57 à 59

ANCILLAIRE	
Référence	Désignation
H03 9102	Ancillaire complet

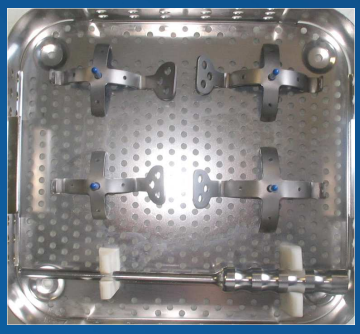

Matériaux :

- **Fond de cotyle** en acier inoxydable 316 L selon ISO 5832-1.
- **Plots** en polyéthylène selon ISO 5834-1 et 2.
- **Vis** en acier inoxydable selon ISO 5832-1

Conditionnement :

Tous les composants sont conditionnés sous vide et stérilisés par rayons Gamma

www.evolutisfrance.com
Avenue de la Libération - 42720 BRIENNON - tél: +33 (0)4 77 60 79 99 - fax: +33 (0)4 77 60 79 90

REF H14 511 05/11

CE 0499